


Ryurei™

Ballon pour angioplastie coronaire à échange rapide semi compliant

Ryurei™ présente une capacité de franchissement supérieure¹ grâce à l'association du bas profil d'entrée et du revêtement hydrophile M-Coat de Terumo. La liaison du ballon courte et le corps renforcé¹ assurent une navigabilité améliorée¹ tout en maintenant un push excellent¹. Ces caractéristiques apportent au médecin la confiance dont il a besoin pour réussir l'intervention, même pendant les cas complexes.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Diamètre du corps	1,9 Fr / 0,64 mm Proximal • 2,5 Fr / 0,84 mm Central • 2,4 Fr / 0,79 mm à 2,7 Fr / 0,89 mm (effilé) Distal (1,00 à 1,50 mm) • 2,6 Fr / 0,87 mm Distal (2,00 à 4,00 mm)
Longueur utile	145 cm
Nb de marqueurs du ballon	1 (Ø 1,0 à Ø 1,5 mm) • 2 (Ø 2,0 à Ø 4,0 mm)
Pression nominale	6 atm / 608 kPa
Pression de rupture nominale	Ø 1,0 - 3,0 mm = 14 atm (1419 kPa) • Ø 3,25 - 4,0 mm = 12 atm (1216 kPa)
Compatibilité avec le guide	Diamètre maximum 0,014" / 0,36 mm
Profil de pénétration dans les lésions	0,41 mm (Ø 1,00 à Ø 1,50 mm) • 0,43 mm (Ø 2,00 à Ø 4,00 mm)
Revêtement	Hydrophile

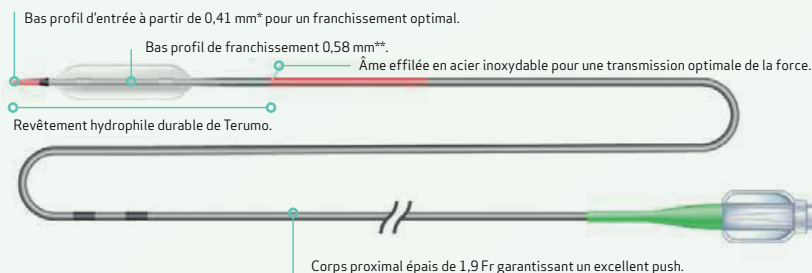

1. Ryurei Ø 1,00-5 mm comparé à Tazuna Ø 1,25-10 mm - Données conservées ISCD-416-31-4 Feb 2018

* Pour Ryurei Ø 1,00 mm - Ø 1,50 mm.

** Pour Ryurei Ø 1,00 mm - 5 mm

Le cathéter de dilatation Ryurei™ est indiqué pour l'angioplastie transluminale percutanée des artères coronaires (P.T.C.A.) dans le but d'améliorer le flux sanguin myocardique dans les sténoses localisées.

Dispositif médical de classe III (CE 2797) fabriqué par Terumo Corporation (Japon). Mandataire Européen : Terumo Europe N.V. (Belgique). Exclusivement réservé aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice avant utilisation. Date de révision : Juin 2019

Veuillez contacter le représentant commercial local Terumo pour plus d'informations.

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

INTERVENTION

